**Ośrodek Badań Podstawowych, Projektów i Wdrożeń, Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS" sp. z o.o.**

ul. Powstańców Śląskich 8
55-010 Święta Katarzyna

sekretariat@oikoslab.pl
https://www.oikoslab.pl/

| Kapitał zakładowy: 100 000,00 PLN | Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS | |
|---|---|---|
| NIP: 8980014132 | Numer REGON: 008374467 | Numer KRS: 0000074393 |

# Instrukcja obsługi próbnika – rurki

| | |
|---|---|
| Metoda | **NIOSH 6016 Method, Issue 1, 15 May 1996** |
| Analit(y) | Amoniak |
| Zawartość rurki | Żel krzemionkowy impregnowany kwasem siarkowym 300/150mg; rurka szklana |
| Przydatność próbnika | 1 rok od daty impregnacji sorbentu; przechowywanie w suchym, ciemnym miejscu |

Jak używać gotowych rurek?
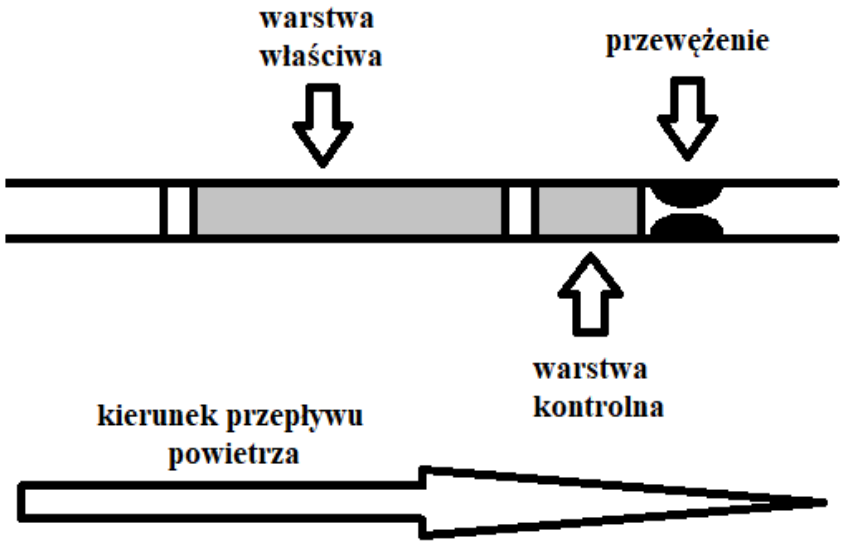
1. Wybierz jedną rurkę do kalibracji przepływu strumienia powietrza przez próbnik. Zdejmij zatyczki z obu końców rurki. Każda rurka składa się z dwóch warstw – pierwszej warstwy właściwej, drugiej warstwy kontrolnej. Na jednym końcu rurka posiada przewężenie. Z tej strony powinna zostać połączona wężykiem z aspiratorem indywidualnym tak, aby próbkowane powietrze przepływało najpierw przez warstwę właściwą.
2. Skalibruj aspirator do zadanego przepływu za pomocą odpowiedniego rotametru
3. Zamień rurkę użytą do kalibracji przepływu na nową rurkę do pobierania próbki. Przymocuj rurkę do kołnierza pracownika możliwie jak najbliżej strefy oddychania pracownika. Pobieraj próbkę w określonym przedziale czasu.
4. Po zakończeniu pobierania próbki rurkę należy zamknąć zatyczkami.
5. Próbkę przechowywać i transportować zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w przewodniku do pobierania próbek, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.oikoslab.pl